

一氧化碳检测试剂盒（酶学法试剂）出厂检验报告

检验日期: 2026-04-02

试剂盒批号: 2260401

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DSJKS001

酶标仪编号/生产许可证号:

酶标仪编号/生产许可证号:

型号	规格
100m(40)	R-40mm ² 检测孔2mm ²

校准品	制造商	批号	有效期至	赋值(mmol/L)	赋值(25℃)
	Shimadzu	2260401	2027-03-31	30.0mmol/L	30.0mmol/L

此试剂盒用于检测一氧化碳浓度，检测结果仅供参考，不作为临床诊断依据。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。


检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

检测结果与标准值偏差在±5%以内，符合出厂标准。

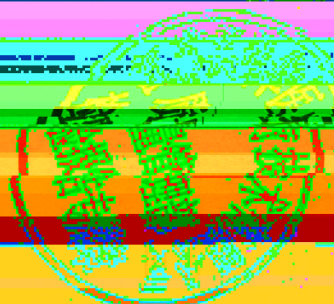

YAB

田洁

田洁